Figure S4

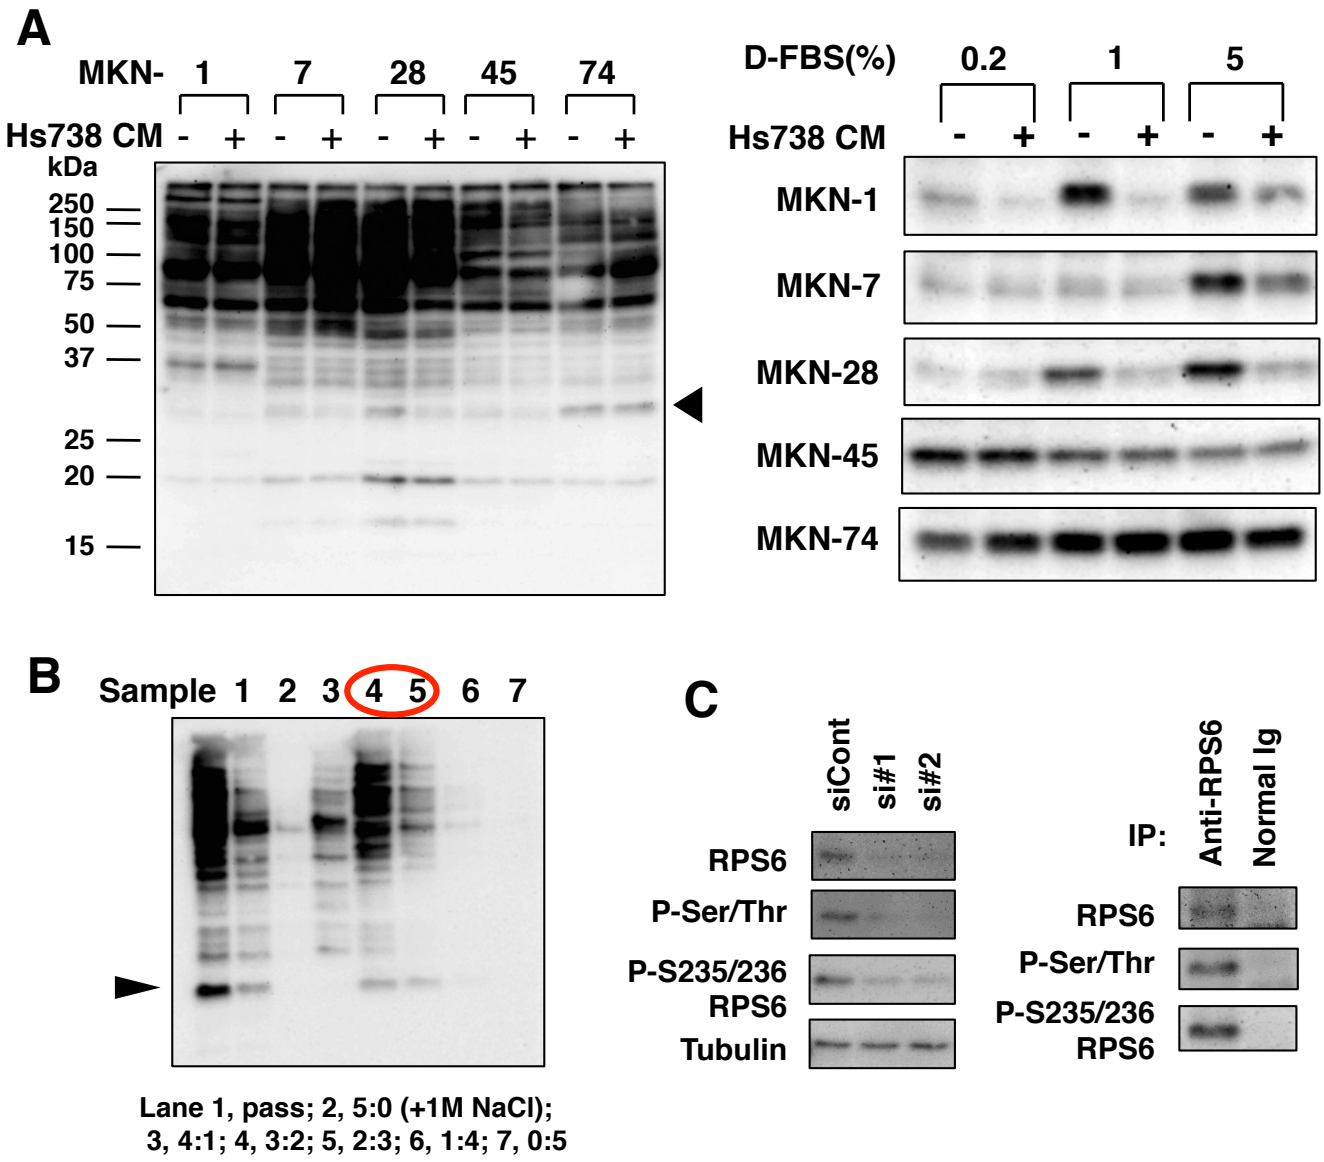
A
MKN- 1 7 28 45 74
Hs738 CM - + - + - + - + - +
kDa
250
150
100
75
50
37
25
20
15
D-FBS(%) 0.2 1 5
Hs738 CM - + - + - +
MKN-1
MKN-7
MKN-28
MKN-45
MKN-74
B
Sample 1 2 3 4 5 6 7
Lane 1, pass; 2, 5:0 (+1M NaCl);
3, 4:1; 4, 3:2; 5, 2:3; 6, 1:4; 7, 0:5
C
siCont
si#1
si#2
RPS6
P-Ser/Thr
P-S235/236 RPS6
Tubulin
IP:
Anti-RPS6
Normal Ig
RPS6
P-Ser/Thr
P-S235/236 RPS6