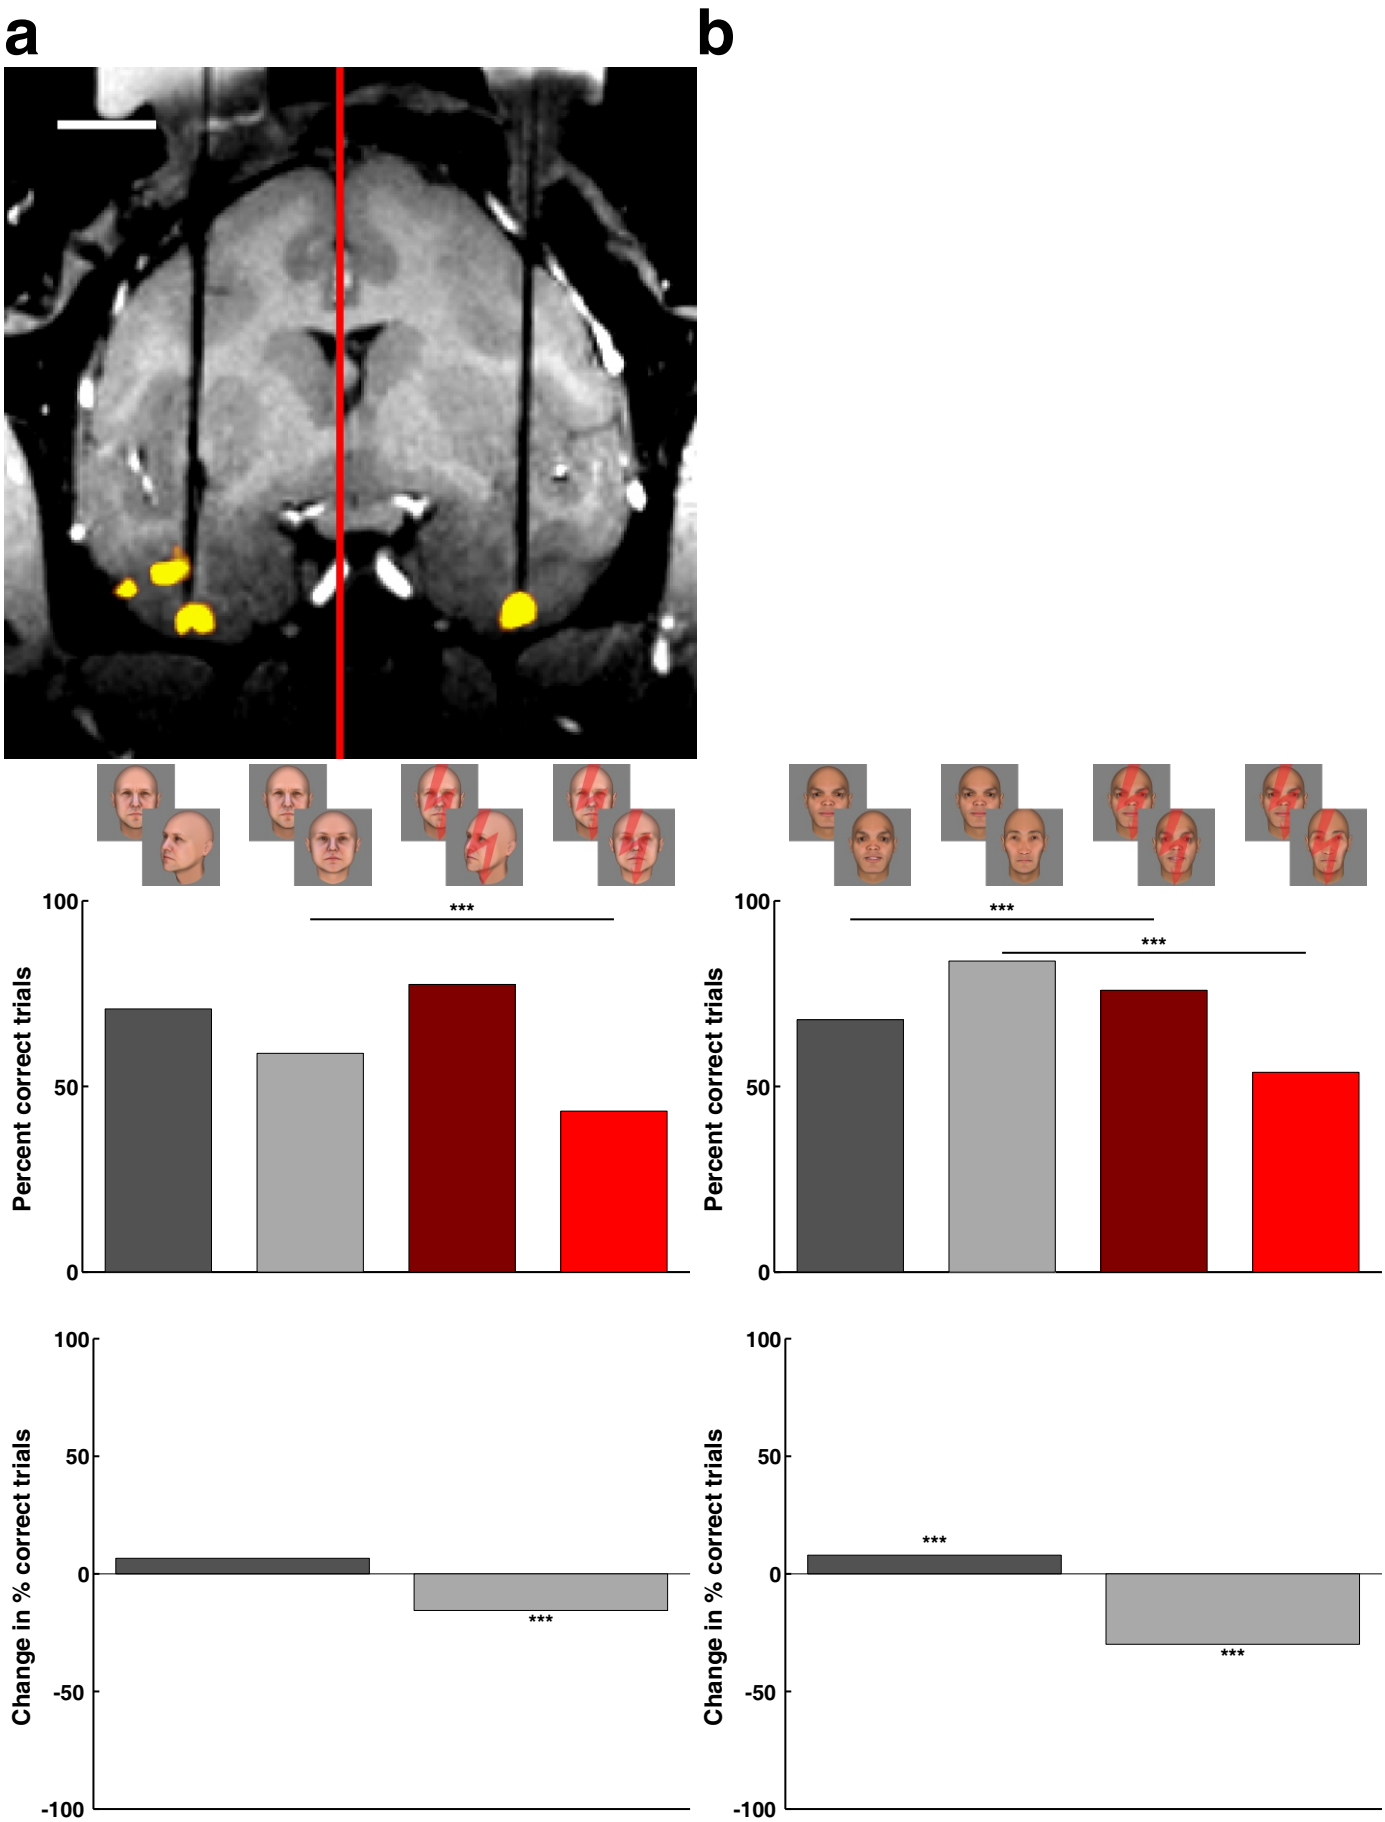
a
b
Percent correct trials
100
50
0
***
Change in % correct trials
100
50
0
-50
-100
***
M1: AM (121008) 100 µA
M1: AM (121102) 300 µA